(a)

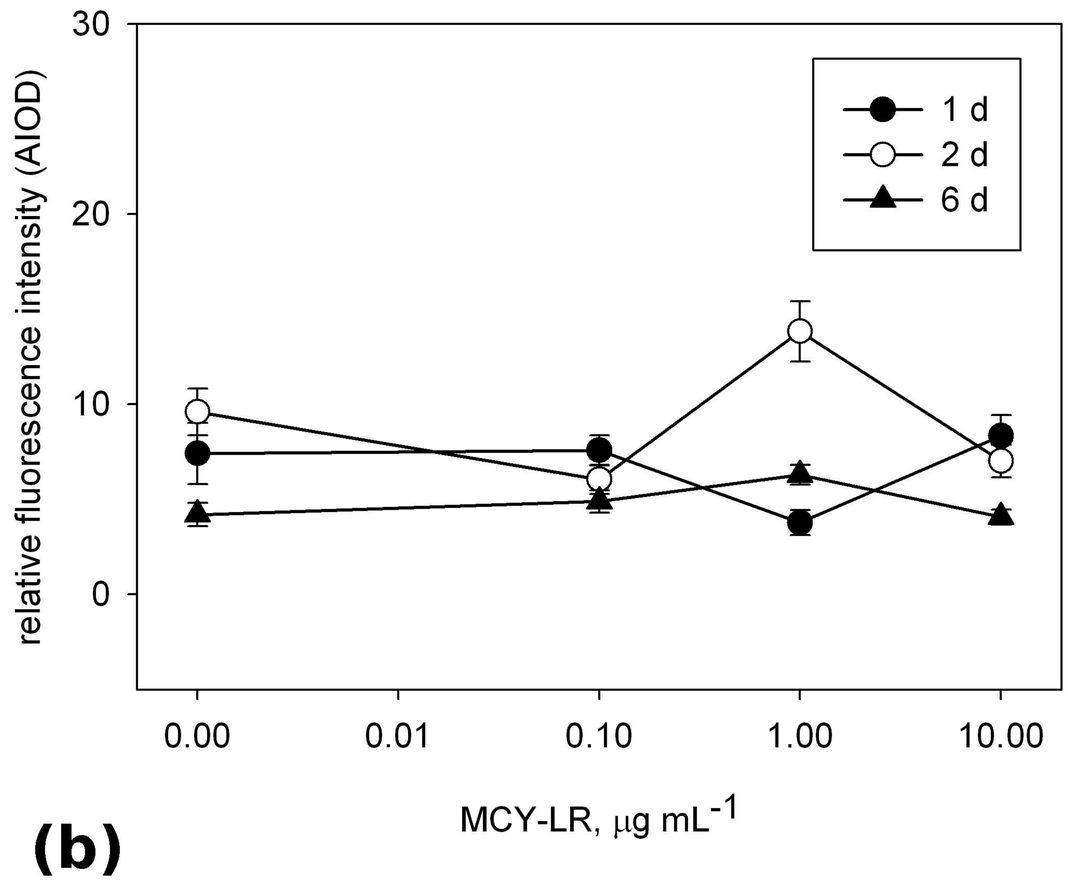
relative fluorescence intensity (AIOD)
30
20
10
0
1 d
2 d
6 d
0.00
0.01
0.10
1.00
10.00
MCY-LR, μg mL-1

(b)

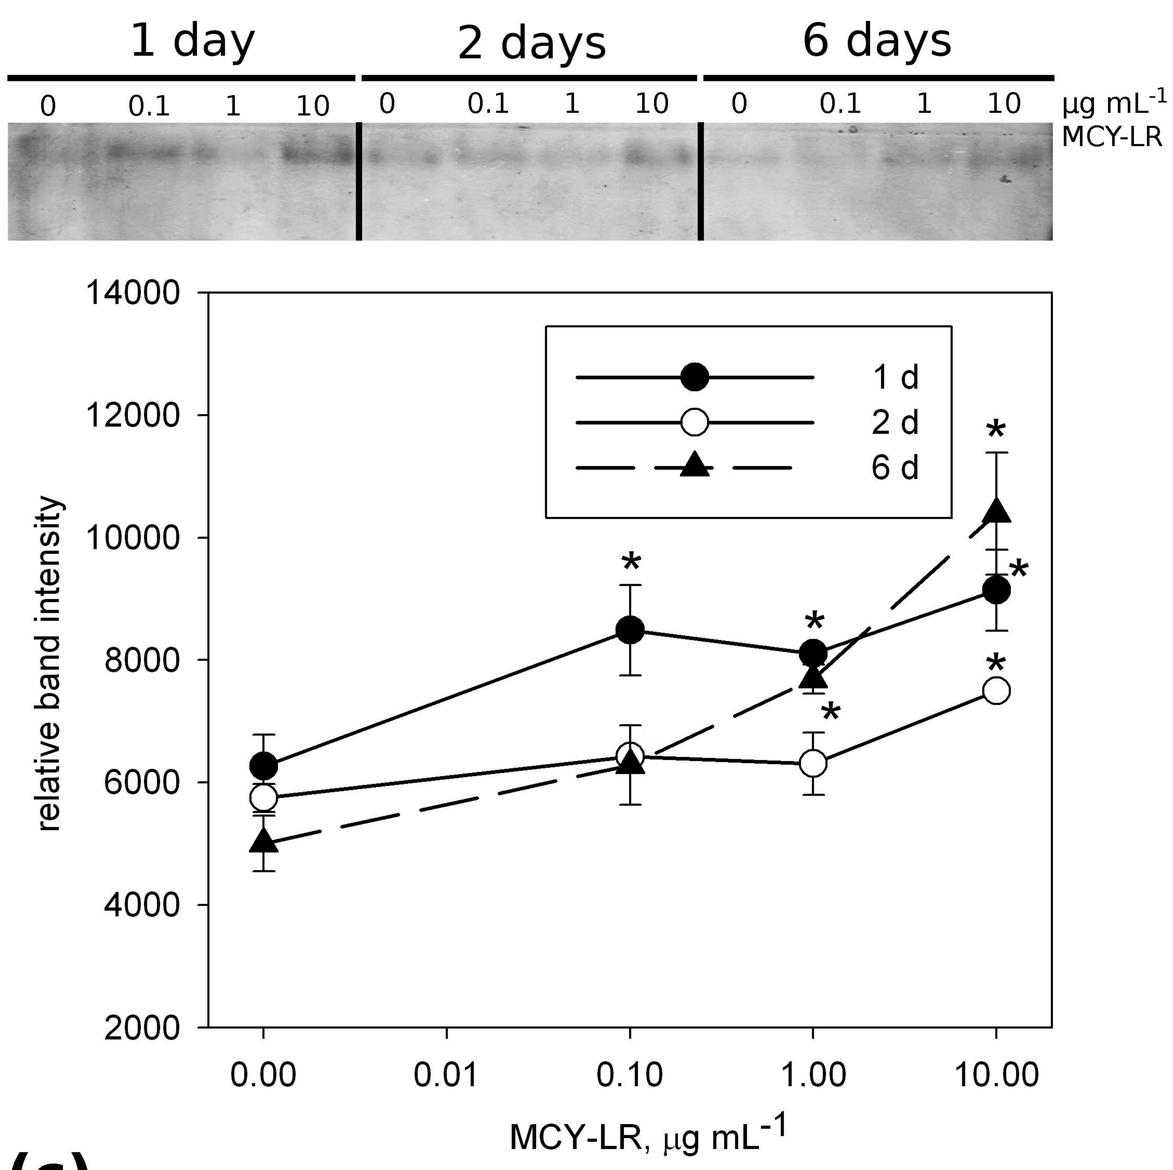
1 day
2 days
6 days
0
0.1
1
10
μg mL-1
MCY-LR
relative band intensity
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
1 d
2 d
6 d
0.00
0.01
0.10
1.00
10.00
MCY-LR, μg mL-1

(c)

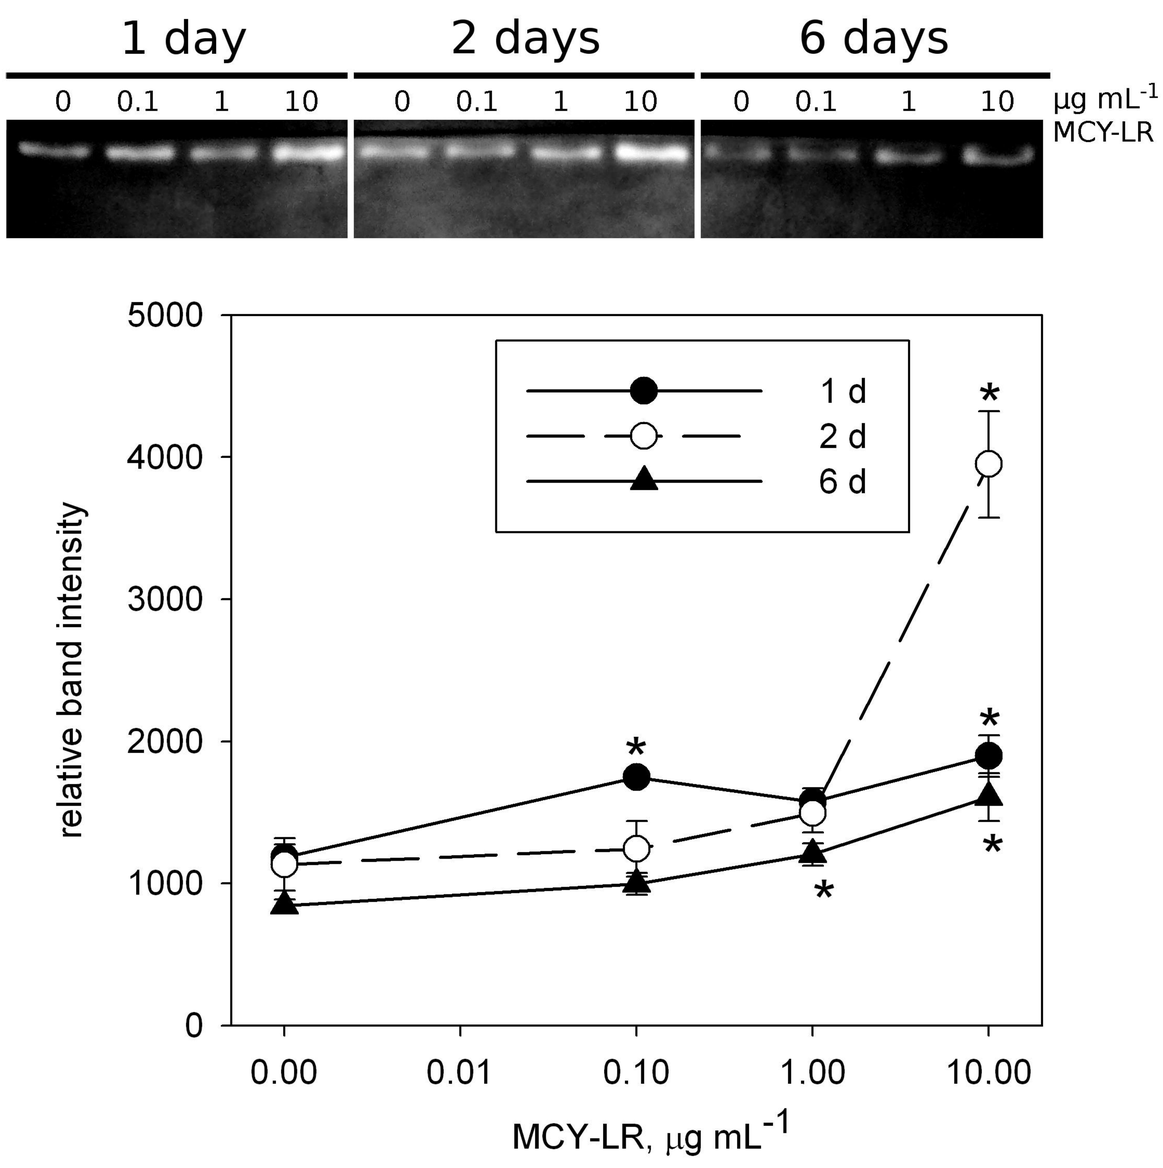
1 day
2 days
6 days
0
0.1
1
10
μg mL-1
MCY-LR
relative band intensity
5000
4000
3000
2000
1000
0
1 d
2 d
6 d
0.00
0.01
0.10
1.00
10.00
MCY-LR, μg mL-1